Mode d'Emploi – tempmate.®

Enregistreur jetable avec rapport PDF via USB, pour certifier la chaine du froid.

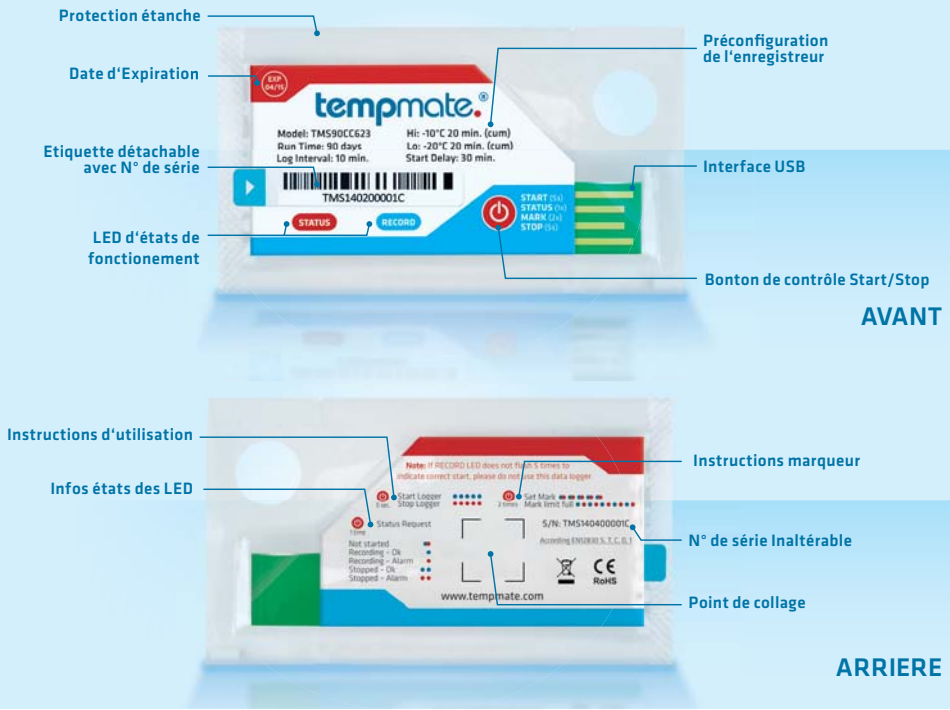

Présentation du produit

Ce document décrit les différentes manipulations a effectuer afin de vous permettre d'utiliser les enregistreurs de température **temp**mate.®, de leur assurer un fonctionnement normal et fiable et vous garantir des mesures durables et précises.

Caractéristiques Techniques

Unité de Température	Celsius (°C)
Plage de Températures	–30 °C à +70 °C
Plage d'utilisation	–30 °C à +70 °C
Résolution	0,1 °C
Précision	±0,5 °C (–20 °C à +40 °C); ±0,1 °C autres plages
Durée d'enregistrement	6, 15, 30, 60 ou 90 jours (selon le modèle)
Seuils d'alarme	Optional available

Type de rapport	Fichier PDF encrypté
Interface	USB (prise intégrée)
Batterie	CR2032 au lithium
Durée de vie	1 an (Date d'Expiration à l'Avant)
OS supportés	Windows et Mac
Fuseau horaire	UTC (UTC = GMT)
Classe Protection	IP67 (étanche)
Dimensions	80.00 mm / 47.3 mm / 4.4 mm (L/l/h)
Poids	approx. 10 g

Axilane instruments
81 rue des Joncs Marins
91620 La Ville du Bois
France

Tél : +33 (0)950.60.40.20
Fax: +33 (0)955.60.40.20
info@axilane.com
www.axilane.com

Mode d'Emploi

01 Presser le bouton START 5 s au minimum pour démarrer l'enregistrement. La LED RECORD s'allume alors 5 fois de suite pour confirmer que l'enregistrement est bien commencé.

02 Pour vérifier l'état de l'enregistreur, presser le bouton START une fois à tout moment. Pour insérer un marqueur dans le futur rapport, presser ce bouton rapidement 2 fois de suite (voir détails des options dans le tableau plus bas).

03 Pour interrompre l'enregistrement, presser le bouton START durant 5 s. La LED STATUS s'allumera alors 5 fois de suite pour confirmer l'arrêt.

04 Après l'arrêt de l'enregistrement, déchirer la pochette de protection et brancher l'enregistreur sur une prise USB de votre PC ou Mac. Le rapport PDF sera généré automatiquement et sera disponible dans le dossier du disque "tempmate".

FONCTIONS du bouton START/STOP

START / STOP

Etat	Action	Confirmation de LED
Démarre l'enregistrement	Presser 5 sec sur le bouton	LED RECORD s'allume 5 fois ●●●●●
Insère une Marque	Double pression rapide	LED STATUS + LED RECORD s'allume 5 fois ●●●●●●●●●●
Arrête l'enregistrement	Presser 5 sec sur le bouton	LED STATUS s'allume 5 fois ●●●●●

Vérifier l'état de l'enregistrement en pressant le bouton START

Etat	Action	Confirmation de LED
Non démarré	Presser le bouton 1 fois	LED STATUS + LED RECORD s'allume 1 fois ●●
Enregistrement – OK	Presser le bouton 1 fois	LED RECORD s'allume 1 fois ●
Enregistrement - Alarme	Presser le bouton 1 fois	LED STATUS s'allume 1 fois ●
Arrêté – OK	Presser le bouton 1 fois	LED RECORD s'allume 2 fois ●●
Arrêté – Alarme	Presser le bouton 1 fois	LED STATUS s'allume 2 fois ●●